

柔性电流探头

CP9000LF系列



深圳市知用电子有限公司

前言

首先，感谢您购买该产品，这份产品使用说明书，是关于该产品的功能、使用方法、操作注意事项等方面的介绍。使用前，请仔细阅读说明书，正确使用。阅读完后请好好保存。说明书中，注释将用以下的符号进行区分。



该符号表示对人体和机器有危害，必须参照说明书操作。

警告

在错误操作的情况下，用户有受伤的威胁，为避免此类危险，记载了相关的注意事项。

注意

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害的可能，为避免此类情况，记载的注意事项。

Note

错误操作时，用户有受轻伤和物质损害事项。

为安全使用本机器，必须严格遵守以下安全注意事项。如果不按照该说明书使用的话，有可能会损害机器的保护功能。此外，违反注意事项进行操作产生的人身安全问题，本公司概不负责。



- 探头 BNC 输出线连接示波器或者其它设备时，确保 BNC 端子可靠接地。
- 被测电路接入探头环之前，确保先关闭被测电路。
- 使用之前，请检查探头环外皮是否有破损，若出现破损情况，请停止使用！
- 接入被测电路前，应避免被测电路有尖刺，锋利的边角容易造成探头环损坏情况发生。
- 探头环上已明确标有使用电压要求，请确保在安全电压范围内使用！
- 选择本产品标配的适配器供电。

1、概述

CP9000LF 系列柔性电流探头采用双量程设计的低频柔性探头。可以实现宽广的电流测量范围，量程设计从 60A 到60kA 的测量范围，环中间保证精度 1%，整个环内精度（环交界处除外）典型值 2%，带宽高达 600kHz (700mm 线圈周长) 或者 1MHz (300 mm 线圈周长)，探头环外径典型值 8mm，耐压值高达 10kVpk，非常适合低频大电流，大功率测试场合。其主要特点包括：线圈轻巧柔软且可以自由插拔，可以探测到许多硬制探头无法达到的地方，轻而易举的实现与被测对象连接；插入损耗几乎为零，仅为几个皮亨，对被测对象近乎为零的干扰；标准的 BNC 输出接口，很方便实现与示波器，数据采集器，数字电压表等连接，观测电流波形；9V 电池供电或者外部 12V DC 电源供电，使用更加灵活方便；过流报警功能，更具人性化设计；探头环和连接线长度可以根据客户要求定制，满足特殊场合测试要求。

2、应用

- 检测低频正弦电流波形
- 分布式电流监控
- 电力母线监测
- 监测谐波、功率以及电能质量
- 大型电动机、泵、风机测试

3、电气规格


3.1 电气参数测量条件：23℃；60%RH；被测导线从探头感应环中心穿过。

型号	灵敏度 (mV/A)		峰值电流 (A)		最大噪声 (mVrms)		低频带宽 -3dB (Hz)	相移 (50Hz)	Peak di/dt(kA/us)		高频带宽-3dB	
	L	H	L	H	L	H			L	H	300mm	700mm
CP9060LF	100	10	60	600	3	1	0.45	<0.85°	0.015	0.25	1MHz	600kHz
CP9120LF	50	5	120	1200	3	1	0.23	<0.5°	0.03	0.5		
CP9300LF	20	2	300	3000	2	1	0.15	<0.35°	0.1	1.2		
CP9600LF	10	1	600	6000	2	1	0.1	<0.25°	0.2	2.5		
CP9121LF	5	0.5	1.2k	12k	2	1	0.08	<0.2°	0.4	5		
CP9301LF	2	0.2	3k	30k	1	0.5	0.07	<0.18°	0.9	6		
CP9601LF	1	0.1	6k	60k	1	0.5	0.07	<0.18°	1.8	6		
CP9122LF	0.5	0.05	12k	120k	1	0.5	0.07	<0.18°	3.5	6		
CP9302LF	0.2	0.02	30k	300k	1	0.5	0.07	<0.18°	6	6		
CP9602LF	0.1	0.01	60k	600k	1	0.5	0.07	<0.18°	6	6		

3.2 其它参数

典型精度	±1%
最大输出电压	±6Vpk
探头环耐压值	10kVpk
终端负载要求	≥100kΩ
供电方式	9V 电池或者外部 DC12V 电源（标配适配器）
安全符合标准	EN61010-1: 2010
EMC 符合标准	EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013


4、产品及附件说明

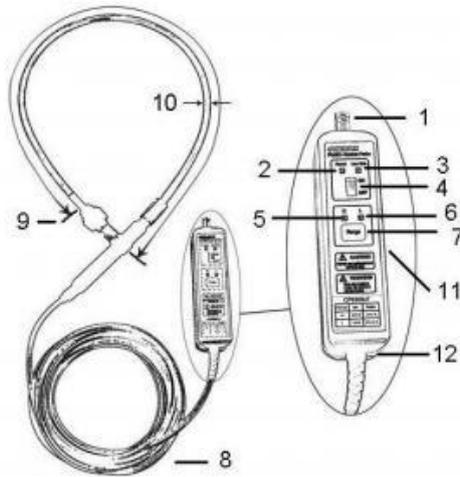


4.1 产品说明

- 1) **信号输出接口**: BNC 标准接口，通过标配 BNC 连接线可接任何厂家示波器等。
- 2) **电源指示灯**: 通电后，该指示灯亮为绿色。
- 3) **低电池报警指示灯**: 电池电压低后，该指示灯亮为红色，提示更换电池。
- 4) **电源开关**: 控制电源开和关。
- 5) **H 档位指示灯**: 大电流档位指示灯。
- 6) **L 档位指示灯**: 小电流档位指示灯。
- 7) **量程选择按键**: 实现 H 和 L 量程的切换。
- 8) **连接线**: 探头和控制盒连接，长度可定制。
- 9) **柔性探头周长**: 典型值 700mm，长度可定制。
- 10) **探头感应环本体直径**: 典型值: 8mm。

4.2 附件说明



同轴电缆输出线(CK-310: 1米)

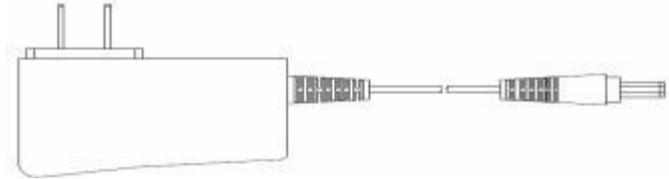

电源适配器(CK-612): DC12V/1A

5、机械规格

型号	CP9000LF
柔性探头周长 典型值（可定制）	700mm
感应环本体直径 典型值	8mm
感应环连接线长	4米（可定制）
BNC连接线长	1米或者2米，标配1米
前端本体尺寸	约 137*33*35mm
探头重量	338g

6、环境特性

工作温度	探头环	-20℃~70℃
	主机	-10℃~55℃
存储温度	-30℃~70℃	
工作湿度	≤85%RH	
存储湿度	≤90%RH	

7、操作方法

- 探头与示波器或其它测量仪器连接时，要求示波器或其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为 $1M\Omega$ (或者 $\geq 100k\Omega$)；根据被测电流大小选择合适的档位，探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如灵敏度为 $50mV/A$ ，示波器设置 20X;灵敏度为 $1mV/A$ ，示波器设置 1000X。
- 使用电池供电或者外部 DC12V 电源供电，拨动开关到开位置，绿色电源指示灯亮。
- 插入被测电流导线，确保电流感应环插头插到位(插到底部为止)，必要时使用旋钮锁住探头，被测导线尽可能从探头感应环中间穿过，否则影响测量精度。
- 被测电路通电。
- 测量结束后，先断开电路，再拔下探头环。
- 断开探头电源，保存好探头。

8、测量时注意事项

Note

- 为保证测量精度，测量时被测导线应穿过探头环中心位置。
- 感应环交界处误差最大，如下图阴影区域，测量误差最大，被测导线应尽量避免该区域。
- 测量时确保探头环插到位(插到底部为止)，否则影响测量精度。
- 测量被测信号时，若附近有强烈磁场干扰源（如多圈线圈组成的磁场辐射源），应尽可能远离，否则会引起测量误差。
- 测量被测信号时，探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源（如 $100V/\mu s$ 以上信号）或者频率达到 MHz 级别以上的干扰源，否则会引起测量误差。
- 判断周围是否有很强干扰源，可以使用如下方法：探头环放在被测导线周围，未夹住导线，测量周围干扰信号强度。
- 下图中箭头方向表示旋钮 LOCK 旋转方向，旋转时锁住探头即可，不能强行旋转过多，造成无法解锁；向相反方向旋转时即为解锁。

注：图中阴影区域误差最大，被测导线应尽量避免该区域



9、保养及维护

- 保持探头的清洁干燥。
- 若需清洁，可用柔软干布擦拭，不可使用化学药剂清洁。
- 不使用探头时，请将其放入所配包装内，置于阴凉、洁净和干燥处。
- 运输探头时，务必放入本公司所配的包装内，可起防震作用
- 不可用力拽拉输入线和输出线，避免过度扭曲、折弯或打结。

10、保修

参照保修卡说明。

11、装箱单

装 箱 单	
电流探头本体	1 个
9V 电池	1 个
DC12V/1A 适配器 (CK-612)	1 个
BNC 输出线(CK-310)	1 根
说明书	1 册
保修卡	1 页
检测报告	1 页

CYBERTEK

深圳市知用电子有限公司

SHENZHEN ZHIYONG ELECTRONICS CO.,LTD.

深圳市龙岗区黄阁北路天安数码城4号大厦A1702

Tel: 400 852 0005 / 0755-8662 8000

Q Q: 400 852 0005

Email: cybertek@cybertek.cn

Url: <http://www.cybertek.cn>

© Zhiyong Electronics, 2025

Published in China, Jul. 1, 2025